

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผู้รับมอบอำนาจ) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๘๗/๒๑ ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๓๖๗๒๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นราคาทั้งสิ้น ๔,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙๓,๐๘๔.๑๑ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ผนวก ๑ และผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน)

ผู้รับมอบอำนาจ

๓.๑ แผนก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๓.๒ แผนก ๒ แค็ตตาล็อก จำนวน ๓๗ (สามสิบเจ็ด) หน้า

๓.๓ แผนก ๓ ใบเสนอราคา บันทึกต่อรองราคา และปริมาณงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายมีหน้าที่ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อโดยไม่มี

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน)

ผู้รับมอบอำนาจ

คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาก่อนนครินทร์ เลขที่ ๕๘๘๙๐๘๑๑๘๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด



(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีธงเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อสามารถส่งของดังกล่าวไว้



(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน)

ผู้รับมอบอำนาจ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละออ ดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เลขที่โครงการ ๒๕๐๓๔๔๑๐๒๔๒

เลขคุมสัญญา ๒๕๐๘๐๑๐๐๕๗๔๘


โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๗/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(.....นายสุรศักดิ์ สมักดี.....)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางละอองดาว บำรุงญาติ.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ความเป็นมา/เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันบริบทของจังหวัดสระบุรี มีจำนวนผู้สูงอายุ เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียงและจำนวนผู้พิการที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงมอบหมายให้กองสาธารณสุข จัดทำโครงการศูนย์สาธิตและยืมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ้น โดยการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสามารถจัดบริการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม และบริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเข้าถึงบริการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

๒.๒ เพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้

๒.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับขายวัสดุที่จะซื้อ

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้


๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้ขายต้องดำเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตามเอกสารแนบท้าย)


 (นางพนัญ ทองเสม)
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ


 (นางสาวสุทธรรดา เป็นเพชร)
 นักวิชาการแผนกส่งเสริมสุขภาพ


 นางสาวสุพินดา แซ่อึ้ง
 นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

-๒-

๕. เงื่อนไขการส่งมอบ

- ๕.๑ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน ส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๕.๒ อุปกรณ์ที่ส่งมอบ จะต้องคงคุณภาพตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๕.๓ การส่งมอบอุปกรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๖. สถานที่ส่งมอบ

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๗. เกณฑ์การคัดเลือก/และพิจารณาคัดเลือก:

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๘. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางพัสดุที่จะซื้อ

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ฯลฯ

สืบราคาท้องตลาด จำนวน ๓ ราย

๘.๑ บริษัท เอส.ที.เมดิคอล ที่ตั้ง : เลขที่ ๑๘๐/๖๒ หมู่ที่ ๖ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘.๒ บริษัท ทีพีที เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด ที่ตั้ง : เลขที่ ๖๕/๕๕ ถนนบางแสนสาย ๓ ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐

๘.๓ บริษัท เอ็น.โอ.ที.เมดิคอล ที่ตั้ง : เลขที่ ๓๑๔ ถนนคตกฤษ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๙. เงินงบประมาณโครงการ

งบประมาณ จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี โดยจ่ายให้กับ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ไว้ในระบบบัญชี ประเภทเงินรับฝากอื่นๆ-ระยะสั้น (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี โครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณ ๖,๗๑๓,๐๐๐.-บาท (หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๐. งานตรวจและการจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินจะกระทำเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้รับอุปกรณ์ถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ตลอดจนได้รับเอกสารครบถ้วน จึงจะมีการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

๖

(นางพณีย์ ทองแสง)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

(นางสาวสุพรรณษา เป็นแพช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๓/๑๑. อัตราค่าปรับ....

นางสาวสุพินตา แซ่อึ้ง

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

๑๑. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. ผู้รับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางพจนิษฐ์ ทองเสม)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวภูพรรษา เอ็นเพชร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวสุพินดา ไช้อึ้ง)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตามโครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการที่ ๑. ที่นอนลม

คุณลักษณะเฉพาะที่นอนลม

๑. ที่นอนลม ทำจากวัสดุไนลอน Nylon และพีวีซี (PVC)
๒. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒ ลอน
๓. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั๊มลม

๑. ขนาดของเครื่องปั๊มลม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘ ซม.
๒. ใช้กระแสไฟฟ้า A ๒๒๐W ,๕๐-๖๐Hz
๓. แรงดัน Pressure ไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลปาสกาล
๔. เวลาในการสลับลม โดยประมาณ ๕-๑๐ นาที

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

รายการที่ ๒. รถเข็นมาตรฐาน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างรถเข็นผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม พับได้
๒. พนักพิงหลังและเบาะนั่งทำจากพลาสติก PVC
๓. เบาะนั่งกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
๔. พนักพิงหลังกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
๕. ล้อซี่ลวดยางตัน
๖. ล้อหลังกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร
๗. ล้อหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
๘. มีเบรกที่มือจับ
๙. รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลกรัม
๑๐. ที่พักเท้าทำจากเหล็ก

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

รายการที่ ๓. รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำจากสแตนเลส
๒. มีช่องสำหรับนั่งถ่าย พร้อมถังใส่ปฏิภาณแบบพลาสติก
๓. ใส่ลูกล้อด้านหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ล้อ
๔. ใส่ล้อซี่ลวดด้านหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร พร้อมยางตัน จำนวน ๒ ล้อ มีเบรคห้ามล้อทั้ง ๒ ข้าง

(นางพจนีย์ ทองเสม)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

(นางสาวภูพรษา เย็นเพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/ส.มีพนักพิง...
นางสาวสุพินดา แซ่อึ้ง
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

-๒-

๕. มีพนักงาน

๖. พื้นนั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๖ เซนติเมตร ยาวขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑ เซนติเมตร

๗. เบาะรองนั่ง หุ้มด้วยหนัง ทรงเหลี่ยม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๖ เซนติเมตร

ยาวไม่น้อยกว่า ๕๑ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร ถอดออกได้

๘. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

รายการที่ ๔. เก้าอี้นั่งถ่าย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เก้าอี้นั่งถ่ายชนิดนั่ง แบบพับไม่ได้

๒. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียม

๓. ที่รองนั่งเป็นฐานสี่เหลี่ยมทำจาก PVC

๔. มีเบาะเสริมรองนั่ง ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม

๕. ที่พักแขนทำจาก PVC

๖. มีถังทิ้งสิ่งปฏิกูล มีหูเท้า สามารถถอดออกทำความสะอาดได้

รายการที่ ๕. สามล้อโยกมาตรฐาน สำหรับคนพิการ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร

ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร

๒. โครงทำด้วยเหล็ก พ่นสีรองพื้นและสีน้ำมัน

๓. พื้นรถทำจากอะลูมิเนียม

๔. เบาะนั่งพองทำด้วยไม้อัดบุด้วยฟองน้ำหุ้ม หนังเทียมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๕. ที่วางแขนเสริมฟองน้ำ

๖. ล้อหน้าและล้อหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร

๗. มีตะกร้า กระดิ่งและกระจกมองหลัง

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

รายการที่ ๖. เตี้ยงปรับระดับได้ ๓ ไก่

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างของตัวเตี้ยงผลิตจากเหล็ก เคลือบสี

๒. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓. ด้านหัวเตี้ยงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือ

๔. ส่วนรองรับตัวคนไข้ แบ่งเป็น ๔ ตอน ตามสรีระของคนไข้

๕. พื้นเตี้ยง มีรูระบายอากาศ

๖. หัวเตี้ยง-ท้ายเตี้ยง ทำจากพลาสติก

๑
(นางพจนีย์ ทองแสง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
11/11/25

✓
(นางสาววิภากรรยา เอ็นเพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๗. ไก่หมุน...
(นางสาวสุพินดา แซ่อึ้ง)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

-๓-

๗. ไกร์หมุน สามารถปรับระดับได้ ๓ ระดับ ดังนี้
 ๑. ปรับด้านหัวเตียงได้ ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา
 ๒. ปรับด้านท้ายเตียงได้ ไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา
 ๓. ปรับสูงต่ำขึ้นลงได้ ไม่น้อยกว่า ๔๐-๗๐ เซนติเมตร จากพื้น
๘. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
๙. รวข้างเตียง เป็นราวอะลูมิเนียมเคลือบสี มีปุ่มล๊อค
๑๐. มีล้อ จำนวน ๔ ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ล้อทั้ง ๔ ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมระบบล๊อคล้อ
๑๑. เบาะทำจากฟองน้ำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร หุ้มด้วยหนัง

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

รายการที่ ๗. ไกร์หมุน ๑ จุด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียม
๒. มีด้ามจับ
๓. ปรับระดับความสูงต่ำได้
๔. ระดับความสูงของไม้เท้า ไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร
๕. มีจุกยางป้องกันการลื่น

รายการที่ ๘. ไกร์หมุน ๓ จุด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม
๒. มีด้ามจับ
๓. ปรับระดับความสูงได้
๔. ระดับความสูงของไม้เท้า ไม่น้อยกว่า ๗๓ เซนติเมตร
๕. มีจุกยางป้องกันการลื่น

รายการที่ ๙. Walker แบบพับได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียมแบบทอกลมมี ๔ ขา
๒. ปดล็อกมือจับทำจากยาง PVC อย่างเหนียว มีความทนทานขณะจับกระชับมือ
๓. ปดล็อกยางยึดแน่นกับโครงอะลูมิเนียมไม่เลื่อนง่าย
๔. มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้ดีไม่เอียงหรือโยกขณะใช้งาน
๕. ขาทั้งสี่ขาอยู่ในแนวระดับเมื่อวางบนพื้น
๖. สามารถพับได้และปรับความสูงได้ตั้งแต่ ๗๘ ถึง ๙๕ เซนติเมตร
๗. ความกว้างด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๕๘ เซนติเมตร
๘. ความกว้างด้านข้างไม่น้อยกว่า ๔๗ เซนติเมตร
๙. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒.๓ กิโลกรัม
๑๐. มีลูกยางรองปลายเท้าด้านล่างทำจาก PVC อย่างเหนียวมีแหวนรองป้องกันลูกยางขาด

/รายการที่ ๑๐...

(นางพจนิษฐ์ ทองเสมอ)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

(นางสาวกฤษณา เอ็นเพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุพินดา แสงอิง
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

-๕-

รายการที่ ๑๐. Walker แบบพับไม่ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตจากอะลูมิเนียมทอกลม มี ๔ ขา
๒. โครงมีขนาดความสูงจากพื้นถึงมือจับไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร
๓. ความกว้างด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร
๔. ความกว้างด้านข้าง ไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร
๕. ปดล็อกมือจับทำจากยาง (PVC) มีความทนทาน ขณะจับกระชับมือ ปดล็อกมือจับยึดแน่นกับโครงอะลูมิเนียม ช่วยกันสั่นได้ดี
๖. ลูกยางของขามีแหวนรอง เพื่อป้องกันลูกยางขาด
๗. มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี ไม่เอียงหรือโยกขณะใช้งาน
๘. ยึดติดโครงด้วยพุกเหล็กเกลียวฝังด้านใน ยึดด้วยน็อต ๘ จุด และยึดด้วยท่อนอะลูมิเนียมค้ำกลางและตัวผู้ด้านล่างเพื่อความมั่นคงและแข็งแรง

รายการที่ ๑๑. Mobile Walker

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงเหล็กสำหรับช่วยพยุงเดิน มีล้อ
๒. โครงสร้างผลิตจากอะลูมิเนียม
๓. สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๘ ระดับ
๔. มีจุดยกกันสั่น
๕. สามารถพับเก็บได้

รายการที่ ๑๒. เติงไม้เตี้ยมีราวกันข้างเตี้ยพร้อมที่นอน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. พื้นเตียงทำจากไม้ หรือ ใช้โครงเหล็กและปิดผิวด้วยลายไม้
๒. เบาะรองนอนรองรับสรีระได้ดี ไม่นิ่มเกินไป กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
๓. ความสูงจากพื้นถึงพื้นเตียง(รวมที่นอน) ไม่น้อยกว่า ๓๐ - ๔๕ เซนติเมตร
๔. ความสูงของราวกันเตียงจากที่นอนขึ้นมา ไม่น้อยกว่า ๒๒ - ๓๓ เซนติเมตร
๕. ความกว้างของเตียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร
๖. ความยาวของเตียงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร
๗. มีราวกัน ๒ ข้าง ทำจากไม้หรืออะลูมิเนียม สามารถพับเก็บหรือสไลด์ลงได้

รายการที่ ๑๓. โต๊ะคร่อมเตียง

คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น

๑. เป็นโต๊ะคร่อมเตียงแบบเปิดไม่ได้ ชนิดสแตนเลส
๒. โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส
๓. มีขนาดหน้าโต๊ะ ไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๔ นิ้ว ยาว ๓๒ นิ้ว หรือ กว้าง ๓๘ เซนติเมตร ยาว ๘๐ เซนติเมตร ขอบโต๊ะหุ้มด้วยผ้าไลหะ ไม่เป็นสนิม

(นางพนีย์ ทองเสม)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

(นางสาวอุพรพรษา เย็นเพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/๔.สามารถ...
นางสาวสุพิชดา แซ่อึ้ง
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

-๕-

๔. สามารถปรับเลื่อนสูง - ต่ำ ขนาดตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๔๕ นิ้ว หรือ ๘๒ ถึง ๑๒๐ เซนติเมตร
 ๕. พื้นบนเป็นไม้อัดหนาอย่างดี บุด้วยโฟมการีสีขาวยก้นร้อน
 ๖. มีล้อ ๔ ล้อ หมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- เงื่อนไขเฉพาะ** รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งาน

รายการที่ ๑๔. เครื่องดูดเสมหะสำหรับผู้ใหญ่

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว
๒. ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๘ ปอนด์ หรือไม่เกิน ๙ กิโลกรัม
๓. Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
๔. มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐ ถึง ๐.๘ บาร์หรือไม่น้อยกว่า ๐ ถึง ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
๕. มีขวดบรรจุเสมหะ
๖. มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง
๗. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

รายการที่ ๑๕. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร

คุณสมบัติทั่วไป

๑. ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก มีที่จับเข็นด้านบนตัวเครื่อง
๒. มีล้อ ๔ ล้อ เพื่อความสะดวกในการเข็นเคลื่อนย้ายและล้อมีเบรกล็อค สามารถล็อคล้อได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๓. เครื่องสามารถผลิตออกซิเจนและฟลักซ์ของยาได้ในเครื่องเดียวกัน
๔. หน้าจอแสดงค่าเวลาการทำงานของเครื่อง
๕. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ในช่วง ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐-๖๐ เฮิรตซ์

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนต่อเนื่องได้ที่ ๐ ถึง ๑๐ ลิตรต่อนาที
๒. ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ไม่น้อยกว่า ๙๓ %
๓. สวิตช์เปิด-ปิด การทำงาน, ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนและช่องสำหรับชุดให้ความชื้นอยู่ทางด้านหน้าเครื่อง เพื่อความสะดวกในการทำงาน
๔. แรงดันขาออกจากตัวเครื่อง สูงสุดไม่น้อยกว่า 0.04 ± 0.007 MPa
๕. สามารถแสดงการทำงานของเครื่องได้ ดังนี้
 - ๕.๑ แรงดันของออกซิเจนที่ออกมา
 - ๕.๒ การตั้งเวลาการทำงานของเครื่อง
๖. มีระบบเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้
 - ๖.๑ เมื่อไฟฟ้าไม่เข้าในเครื่อง หรือไฟฟ้ามีปัญหา
 - ๖.๒ แรงดันของออกซิเจนต่ำหรือสูงเกินไป

(นางพนีย์ ทองเสม)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

(นางสาวกัญทิรา เอินเพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/พ.ระดับ...
นางสาวสุพณา แซ่อึ้ง
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

-๖-

๗. ระดับความดังของเสียงขณะใช้งาน ไม่เกินกว่า ๖๐ เดซิเบล
๘. มีเครื่องฟั่นละอองยาด้วยแรงดันอากาศทั่วไป สำหรับการรักษาด้วยยาขยายหลอดลม ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ประกอบ

๑. สาย Oxygen cannula	จำนวน	๑	เส้น
๒. ชุดฟั่นละอองยา	จำนวน	๑	ชุด
๓. กระป๋องน้ำให้ความชื้น	จำนวน	๑	ใบ
๔. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	จำนวนอย่างละ	๑	เล่ม

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

รายการที่ ๑๖. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร

คุณสมบัติทั่วไป

๑. ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก
๒. มีล้อ ๔ ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและล้อมีเบรกล็อค สามารถล็อกล้อได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๓. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ในช่วง ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ ลิตรต่อนาที
๒. แรงดันขาออกจากตัวเครื่อง สูงสุดไม่น้อยกว่า 0.05 ± 0.005 MPa
๓. ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน ไม่น้อยกว่า $93 \pm 3\%$
๔. มีแถบสัญลักษณ์สี เพื่อแสดงสถานะของก๊าซออกซิเจนที่เครื่องสามารถสกัดได้ พร้อมข้อความ High หรือ Low
๕. สามารถแสดงค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนเป็นตัวเลขดิจิตอลที่เครื่องสามารถสกัดออกมาได้ตลอดเวลา (Real time)
๖. มีข้อความแสดงสถานะเครื่อง ทำงานปกติ(Normal)
๗. มีระบบเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้
 - ๗.๑ เมื่อไฟฟ้าไม่เข้าในเครื่อง หรือไฟฟ้ามีปัญหา
 - ๗.๒ แรงดันของออกซิเจนต่ำหรือสูงเกินไป
๘. ระดับความดังของเสียงขณะใช้งาน ไม่เกินกว่า ๔๐ เดซิเบล

อุปกรณ์ประกอบ

๑. สาย Oxygen cannula	จำนวน	๑	เส้น
๒. กระป๋องน้ำให้ความชื้น	จำนวน	๑	ใบ
๓. ชุดฟั่นละอองยา	จำนวน	๑	ชุด
๔. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	จำนวนอย่างละ	๑	เล่ม

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

(นางพจนีย์ ทองเสมอ)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

(นางสิริวิภา ทรัพย์รักษา เป็นเพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุพินดา แฉอั้ง
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ


โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แคตตาล็อกแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๗ /๒๕๖๙
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓๗ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(.....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางละอองดาว บำรุงญาติ.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


บริษัท บีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑๐ ถนนสาย ๑๐๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๖-๔๖๐๐๐๐๐ โทรสาร ๐๔๖-๔๖๐๐๐๐๑
เว็บไซต์ www.bm-thailand.com

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ตามโครงการศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมเครื่องมือเครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการที่ ๑. ที่นอนลม



คุณลักษณะเฉพาะที่นอนลม


1. ที่นอนลม ทำจากวัสดุไนลอน Nylon และพีวีซี (PVC)
2. จำนวนไม่น้อยกว่า 22 ตอน
3. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั๊มลม

1. ขนาดของเครื่องปั๊มลม กว้างไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 8 ซม.
2. ใช้กระแสไฟฟ้า A 220W ,50-60Hz
3. แรงดัน Pressure ไม่น้อยกว่า 15 กิโลปาสคาล
4. เวลาในการสลับลมโดยประมาณ 5-10 นาที

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันภาพสินค้า อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

รายการที่ 2 รถเข็นมาตรฐาน



คุณลักษณะเฉพาะ


1. โครงสร้างรถเข็นผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม พับได้
2. พนักพิงหลังและเบาะนั่งทำจากพลาสติก PVC
3. เบาะนั่งกว้าง ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
4. พนักพิงหลังกว้าง ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
5. ถังใส่ล้อข้างคัน
6. ถังหลังกว้าง ไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
7. ถังหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
8. มีเบรคที่มือจับ
9. รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม
10. ที่พักเท้าทำจากเหล็ก

-เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

(Handwritten signature)



รายการที่ 3. รถเข็นอาบนํ้านั่งถ่าย




คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากสแตนเลส
2. มีช่องสำหรับนั่งถ่าย พร้อมถังใส่ปฏิกูลแบบพลาสติก
3. ใต้ถ่กล้อด้านหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร จำนวน 2 ถ่
4. ใต้ถ่ล้อด้านหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร พร้อมยางดัน จำนวน 2 ถ่ มีเบรคห้ามล้อทั้ง 2 ข้าง
5. มีพนักพิง
6. พื้นนั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร ยาวขนาดไม่น้อยกว่า 51 เซนติเมตร
7. เบาะรองนั่ง หุ้มด้วยหนัง ทรงเหลี่ยม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร
8. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้างอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ



รายการที่ 4. เก้าอี้นั่งถ่าย



คุณลักษณะเฉพาะ

1. เก้าอี้นั่งถ่ายชนิดนั่ง แบบพับไม่ได้
2. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียม
3. ที่รองนั่งเป็นฐานสี่เหลี่ยมทำจาก PVC
4. มีเบาะเสริมรองนั่ง ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม
5. ที่พักแขนทำจาก PVC
6. มีถังทิ้งสิ่งปฏิกูล มีหูหิ้ว สามารถถอดออกทำความสะอาดได้

BM

Baanmor(Thailand)CO.,LTD.

บริษัท บ้านมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๕-๕๕๕๕ โทรสาร ๐๒-๕๕๕-๕๕๕๕

สาขา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่



รายการที่ 5. ตามล้อโยกมาตรฐาน สำหรับคนพิการ



คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.ขนาดตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
 2. โครงทำด้วยเหล็ก พ่นสีรองพื้นและสีน้ำมัน
 3. พื้นรถทำจากอะลูมิเนียม
 - 4.เบาะนั่งพนักพิงทำด้วยไม้อัดคลุมด้วยพองน้ำหุ้ม พนักเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
 - 5.ที่วางแขนเสริมพองน้ำ
 - 6.ล้อหน้าและล้อหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
 7. มีตะกร้า กระเบื้องและกระงะกมองหลัง
- เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ


7

BM

Baanmor(Thailand) CO.,LTD.

B-MED


รายการที่ 6. เตียงปรับระดับได้ 3 ไก้



คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็ก เคลือบสี
2. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
3. ด้านหัวเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือ
4. ส่วนรองรับตัวคนไข้ แบ่งเป็น 4 ตอน ตามสรีระของคนไข้
5. พื้นเตียง มีระบายอากาศ
6. หัวเตียง-ท้ายเตียง ทำจากพลาสติก
7. ไก้หมุน สามารถปรับระดับได้ 3 ระดับ ดังนี้
 - 7.1 ปรับด้านหัวเตียงได้ ไม่น้อยกว่า 70 องศา
 - 7.2 ปรับด้านท้ายเตียงได้ ไม่น้อยกว่า 35 องศา
 - 7.3 ปรับสูงต่ำขึ้นลงได้ ไม่น้อยกว่า 40-70 เซนติเมตร จากพื้น
8. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
9. ราวข้างเตียง เป็นราวอะลูมิเนียมเคลือบสี มีไม่ลื่น

รายการที่ 7. ไม้เท้า 1 จุด



คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียม
2. มีด้ามจับ
3. ปรับระดับความสูงต่ำได้
4. ระดับความสูงของไม้เท้า ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
5. มีจุดยางป้องกันการลื่น


7

รายการที่ 8. ไม้เท้า 3 จุด




คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม
2. มีด้ามจับ
3. ปรับระดับความสูงได้
4. ระดับความสูงของไม้เท้า ไม่น้อยกว่า 73 เซนติเมตร
5. มีลูกยางป้องกันการลื่น



รายการที่ 9. Walker แบบพับได้




คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียมแบบทอกลมมี 4 ขา
2. ปุ่มมือจับทำจากยาง PVC อย่างเหนียว มีความทนทานขณะจับกระชับมือ
3. ปุ่มยางยึดแน่นกับโครงอะลูมิเนียมไม่เลื่อนง่าย
4. มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้ดีไม่เอียงหรือโยกขณะใช้งาน
5. ขาทั้งสี่ขาอยู่ในแนวระดับเมื่อวางบนพื้น
6. สามารถพับได้และปรับความสูงได้ตั้งแต่ 78 ถึง 95 เซนติเมตร
7. ความกว้างด้านหน้าไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร
8. ความกว้างด้านข้างไม่น้อยกว่า 47 เซนติเมตร
9. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.3 กิโลกรัม
10. มีลูกยางรองปลายเท้าด้านล่างทำจาก PVC อย่างเหนียวมีแหวนรองป้องกันลูกยางขาด

✓

รายการที่ 10. Walker แบบพับไม่ได้




คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมท่อกลม มี 4 ขา
2. โครงมีขนาดความสูงจากพื้นถึงมือจับไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
3. ความกว้างด้านหน้าไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
4. ความกว้างด้านข้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร
5. ปดอกมือจับทำจากยาง (PVC) มีความทนทาน ขณะจับกระชับมือ ปดอกมือจับยึดแน่นกับ โครงอะลูมิเนียม

ช่วยกันเดินได้ดี

6. ลูกยางของขามีแหวนรอง เพื่อป้องกันลูกยางขาด
7. มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี ไม่เอียงหรือโยกขณะใช้งานขาทั้ง 4 ขา อยู่ในแนวระดับเมื่อวางบนพื้นรับน้ำหนักได้อย่างดี ไม่เอียงหรือโยกเยก
8. ยึดติด โครงด้วยทุกเหล็กเกลียวฝังด้านใน ยึดด้วยน็อต 8 จุด และยึดด้วยท่อนอะลูมิเนียมก้ำกลางและตัวคู่ด้านข้างเพื่อ ความมั่นคงและแข็งแรง

รายการที่ 11. Mobile Walker




คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงเหล็กสำหรับช่วยพยุงเดิน มีล้อ
2. โครงสร้างผลิตจากอะลูมิเนียม
3. สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ
4. มีจุดยกกันลิ้น
5. สามารถพับเก็บได้

7

รายการที่ 12. เตียงไม้เตี้ยมีราวกันข้างเตียงพร้อมที่นอน



คุณลักษณะเฉพาะ

1. พื้นเตียงทำจากไม้ หรือ ใช้โครงเหล็กและปิดผิวด้วยลายไม้
2. เบาะรองนอนรองรับศีรษะได้ดี ไม่นิ่มเกินไป กว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตรหนา ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
3. ความสูงจากพื้นถึงพื้นเตียง(รวมที่นอน) ไม่น้อยกว่า 30 - 45 เซนติเมตร
4. ความสูงของราวกันเตียงจากที่นอนขึ้นมา ไม่น้อยกว่า 22-33 เซนติเมตร
5. ความกว้างของเตียง ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
6. ความยาวของเตียง ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร
7. มีราวกัน 2 ข้าง ทำจากไม้หรือลูมิเนียม สามารถพับเก็บหรือสไลด์ลงได้

บริษัท บานมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๐ ถนนสาย ๑๐๐ ตำบล ๑๐๐ อำเภอ ๑๐๐ จังหวัด ๑๐๐
เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๐ ถนนสาย ๑๐๐ ตำบล ๑๐๐ อำเภอ ๑๐๐ จังหวัด ๑๐๐

รายการที่ 13. โต๊ะคร่อมเตียง



คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น

1. เป็นโต๊ะคร่อมเตียงแบบเปิดไม่ได้ ชนิดสแตนเลส
 2. โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส
 3. มีขนาดหน้าโต๊ะ ไม่น้อยกว่า กว้าง 14 นิ้ว ยาว 32 นิ้ว หรือ กว้าง 38 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร ขอบโต๊ะหุ้มด้วยผ้าโลหะ ไม่เป็นสนิม
 4. สามารถปรับเลื่อนสูง -ต่ำ ขนาดตั้งแต่ 30 ถึง 45 นิ้ว หรือ 82 ถึง 120 เซนติเมตร
 5. พื้นบนเป็นไม้อัดหนาอย่างต่ำ มีผิวโพรมีเทอรัลสีขาวกันรอยขีดข่วน
 6. มีล้อ 4 ล้อ หมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ หรือบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งาน


บริษัท บานนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่...../...../.....

วันที่...../...../.....

เลขที่...../...../.....

รายการที่ 14. เครื่องดูดเสมหะสำหรับผู้ใหญ่




คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว
2. ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
3. Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
4. มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 0.8 บาร์หรือไม่น้อยกว่า 0 ถึง 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
5. มีขั้วครบรูดูดเสมหะ
6. มีระบบป้องกันเสมหะในขวดลิ้นเข้าเครื่อง
7. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

Z

บริษัท บานนอร์ ประเทศไทย จำกัด
เลขที่ ๓๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๒๖๒๖๒ โทรสาร ๐๒-๒๖๒๖๒๖๓
เว็บไซต์ www.baannor.co.th E-mail info@baannor.co.th

รายการที่ 15. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร



คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก มีที่จับเข็นด้านบนตัวเครื่อง
2. มีล้อ 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเข็นเคลื่อนย้ายและล้อมีเบรกล็อค สามารถล็อคล้อได้อย่างน้อย 2 ล้อ
3. เครื่องสามารถผลิตออกซิเจนและฟลักซ์ออกซิเจนได้ในเครื่องเดียวกัน
4. หน้าจอแสดงค่าเวลาการทำงานของเครื่อง
5. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ในช่วง 220 โวลต์ ความถี่ 50-60 เฮิรตซ์

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

1. สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนต่อเนื่องได้ที่ 0 ถึง 10 ลิตรต่อนาที
2. ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ไม่น้อยกว่า 93 %
3. สวิตช์เปิด-ปิด การทำงาน, ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนและช่องสำหรับชุดให้ความชื้นอยู่ทางด้านหน้าเครื่อง เพื่อความสะดวกในการทำงาน
4. แรงดันขาออกจากตัวเครื่อง สูงสุด ไม่น้อยกว่า 0.04±0.007 MPa



ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....

.....

.....

.....

5. สามารถแสดงการทำงานของเครื่องได้ ดังนี้

5.1 แรงดันของออกซิเจนที่ออกมา

5.2 การตั้งเวลาการทำงานของเครื่อง

6. มีระบบเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้

6.1 เมื่อไฟฟ้าไม่เข้าในเครื่อง หรือไฟฟ้ามีปัญหา

6.2 แรงดันของออกซิเจนต่ำหรือสูงเกินไป

7. ระดับความดังของเสียงขณะใช้งาน ไม่เกินกว่า 60 เดซิเบล

8. มีเครื่องฟ่นละอองยาด้วยแรงดันอากาศทั่วไป สำหรับการรักษาด้วยยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ประกอบ

1. สาย Oxygen cannula จำนวน 1 เส้น

2. ชุดฟ่นละอองยา จำนวน 1 ใบ

3. กระป๋องน้ำให้ความชื้น จำนวน 1 ชุด


4. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 เล่ม

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

7



รายการที่ 16. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร



คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก
2. มีล้อ 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและล้อมีเบรกล็อค สามารถล็อคล้อได้อย่างน้อย 2 ล้อ
3. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ในช่วง 220 โวลต์ ความถี่ 50-60 เฮิรตซ์

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1. สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ลิตรต่อนาที
2. แรงดันขาออกจากตัวเครื่อง สูงสุด ไม่น้อยกว่า 0.05 ± 0.005 MPa
3. ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน ไม่น้อยกว่า $93 \pm 3\%$
4. มีแถบสัญลักษณ์สี เพื่อแสดงสถานะของก๊าซออกซิเจนที่เครื่องสามารถสกัดได้พร้อมข้อความ High หรือ Low
5. สามารถแสดงค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนเป็นตัวเลขดิจิทัลที่เครื่องสามารถสกัดออกมาได้ตลอดเวลา (Real time)
6. มีข้อความแสดงสถานะเครื่อง ทำงานปกติ(Normal)
7. มีระบบเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้
 - 7.1 เมื่อไฟฟ้าไม่เข้าในเครื่อง หรือไฟฟ้ามีปัญหา




7.2 แรงดันของออกซิเจนต่ำหรือสูงเกินไป

8. ระดับความดังของเสียงขณะใช้งาน ไม่เกินกว่า 40 เดซิเบล

อุปกรณ์ประกอบ

1. สาย Oxygen cannula จำนวน 1 เส้น
2. ชุดพื้นละอองยา จำนวน 1 ใบ
3. กระป๋องน้ำให้ความชื้น จำนวน 1 ชุด
4. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 เล่ม


เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการบริหารบริษัทบ้านหมอ(ประเทศไทย)จำกัด

(นายไชยงค์ ถิหมัด)




ALTERNATING PRESSURE MATTRESS WITH PUMP



T01+P01


ISO13485 FDA CE MDR MDMA



Aircells Cyclic Fluctuation, Alternating Pressure Release

● Air cell A

● Air cell B



- ▼ Stage II medium treatment
- ▼ A-B lines air tubes alternating for anti bedsores/decubitus
- ▼ CPR for quick air release in emergency
- ▼ 2-way stretch PU cover with snap fixture, fire retardant, waterproof (option)
- ▼ Warranty: 1 year

MATTRESS C01

Size: 275*120*100mm
Mattress material: High PVC or Nylon-CPU
Cover material: PU stretch cover
Net weight: 5.21kg
Weight capacity: 145kg
12 Air cells and 12 air tubes

PUMP P01S

Power: 110V/50Hz or 220V/50Hz
Air output: 7L/min
Cycle time: 1-10 mins
Power consumption: 35W
Fuse: 0.5A
Size: 275*120*100mm (L*W*H)
Net Weight: 1.15kg

P01



Static mode
Size: 275*120*100mm (L*W*H)
Net Weight: 1.15Kg

BM
Baanmor(Thailand) CO., LTD.

ออกแบบเพื่อความสะดวก สบาย ปลอดภัย

รถเข็นผู้ป่วย

WHEELCHAIR

แข็งแรง ทนทาน มั่นใจทุกการใช้งาน

รถเข็นผู้ป่วยโครงสร้างแข็งแรง
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ออกแบบเพื่อความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน
เหมาะสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว



ใช้ได้โรงพยาบาล
คลินิก



ใช้ที่บ้าน
ดูแลผู้ป่วย



พกพา สะดวก
ใช้งานง่าย

คุณสมบัติสินค้า

- 1 ผลิตจากเหล็กชุบสีโครเมียม
- 2 เบาะหนังเทียม (PU) สดดำ
- 3 ล้อหน้ายางตัน 8 นิ้ว , ล้อหลังยางตัน 24 นิ้ว
- 4 มีเบรกมือและเบรกล้อ
- 5 เบาะลึก 45 เซนติเมตร กว้าง 45 เซนติเมตร
- 6 เข็มขัดนิรภัยคาดเอว
- 7 พับเก็บได้
- 8 รับน้ำหนักสุกั 100 กิโลกรัม

จุดเด่นสินค้า



เบรกมือ เพิ่มความปลอดภัย
ควบคุมได้ง่าย




เบรกล้อ ล็อกล้อได้มั่นคง
ปลอดภัยขณะหยุดนิ่ง



**เข็มขัดนิรภัย
คาดเอว** เพิ่มความปลอดภัย
ขณะนั่ง




ที่วางเท้า สามารถพับเก็บได้
สะดวกในการขึ้น-ลง




พับเก็บได้
ประหยัดพื้นที่
พกพาสะดวก



มุมมองด้านหน้า



มุมมองด้านหลัง



มุมมองด้านข้าง



พับเก็บได้

ข้อมูล
ทางเทคนิค



ความกว้างที่นั่ง

45
ซม.



ความลึกที่นั่ง

45
ซม.



ความสูงจากพื้น
ถึงเบาะนั่ง

49
ซม.



ความสูงพนักหลัง

43
ซม.



ล้อหน้า

8
นิ้ว



ล้อหลัง

24
นิ้ว



รับน้ำหนัก
สุกั

100
กก.




บริษัท... จำกัด



3.คุณลักษณะเฉพาะของเข็นอานน้ำหนักง่าย

2. มีห้องสำหรับนั่งอาน พร้อมถังใส่ปุ๋ยติดแบบพลาทิก



4. ใต้ล้อฉีดพ่นหัวถัง ขนาด ไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร พร้อมยางตัน จำนวน 2 ล้อ มีเบรคห้ามล้อทั้ง 2 ด้าน


3. ใต้ถังล้อด้านหน้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร จำนวน 2 ล้อ

1. โครงสร้างทำจากสแตนเลส, 8. สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม






4.คุณลักษณะเก้าอี้ถ่าย



รถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ



เพิ่มอิสระในการเดินทาง เพิ่มคุณภาพชีวิต

เพิ่มอิสระในการเดินทาง เพิ่มคุณภาพชีวิต

คุณสมบัติเด่น

- ✓ โครงสร้างเหล็กแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ✓ ระบบคันโยกใช้งานง่าย ช่วยลดแรงในการขับเคลื่อน
- ✓ เบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ นั่งสบาย
- ✓ มีตะกร้าหน้าสำหรับใส่สิ่งของ
- ✓ ติดตั้งกระจกมองหลัง และกระดิ่งเพื่อความปลอดภัย
- ✓ เหมาะสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- 1 โครงสร้างของรถผลิตจากเหล็กหนา มีขนาดกว้างยาว สูง ไม่เกินกว่า 75 ซม. 60 ซม. 70 ซม. ตามลำดับ
- 2 พื้นรถทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร พื้นสีรองพื้นและสีน้ำมัน
- 3 เบาะนั่งขนาดไม่น้อยกว่า 48 x 40 เซนติเมตร
- 4 พนักพิงทรงสูง รองรับแผ่นหลังได้ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 48 x 25 เซนติเมตร ผลิตจากฟองน้ำอัด หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- 5 ที่พักแขนเสริมพองน้ำ พร้อมแผ่นป้องกันขานเลื้อยเข้าไปในซี่ล้อ และมีบังโคลนล้อหน้า ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่คงทน ทำความสะอาดง่าย
- 6 ล้อหน้าและล้อหลัง ขนาด 24 x 1.75 นิ้ว หรือ 24 x 1 1/4 นิ้ว แบบสลับ ไม่เป็นสนิม
- 7 ระบบเบรกล้อหน้าแบบเบรกก้ามปู ควบคุมด้วยมือขึ้น อย่างน้อย 1 ซ้าย
- 8 มีตะกร้าสำหรับใส่ของ กระดิ่ง กระจกมองหลัง และวัสดุสะท้อนแสง ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งด้านซ้ายและขวา อย่างน้อย 1 จุด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเวลากลางคืน
- 9 ชุดก้านคันโยกแข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งาน ทนทาน เบาแรงในการโยก ระดับก้านโยกเหมาะสม สะดวกต่อการขึ้นและลงรถ
- 10 จานข้อเหวี่ยงออกแบบให้มีตัวถ่วงน้ำหนัก ช่วยแก้เส้นหักแรงขณะโยก เพิ่มความนุ่มนวลในการใช้งาน
- 11 ชุดโยกและชุดเพลาอิสระ สามารถถอดซ่อมบำรุงได้
- 12 รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ 200 กิโลกรัม

ข้อมูลสำคัญ



รองรับน้ำหนักได้
200 กิโลกรัม



ล้อสลับ
ขนาด **24 นิ้ว**





ระบบขับเคลื่อน
ด้วยคันโยก



เบาะนั่งกว้าง นั่งสบาย
พนักพิงสูง รองรับแผ่นหลังได้ดี



มีตะกร้าหน้า กระจกมองหลัง
และกระดิ่ง เพื่อความปลอดภัย





เคลื่อนไหวอย่างอิสระ มั่นใจทุกการเดินทาง

รถสามล้อโยกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว




เตียง 3 โกร้ มือหมุน ราวโลหะ หัวท้ายABS Model : BM011 เกษตรหัวท้ายโลหะ

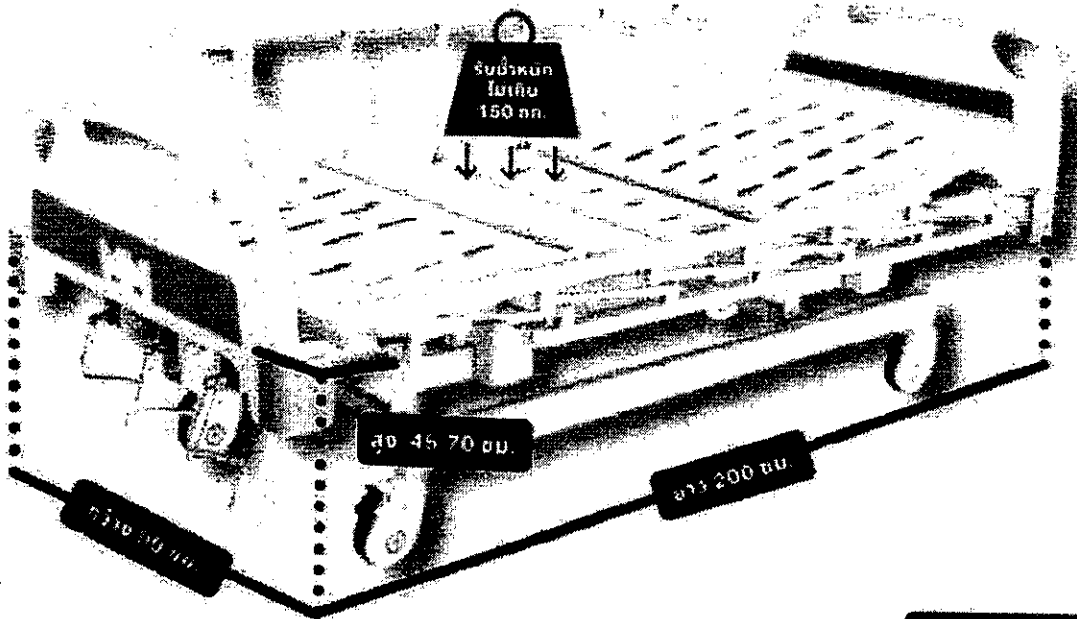

พลาสติกขึ้นรูป ABS



ระบบ 3 โกร้มือหมุน



ล้อกิ้งไซด์

รับประกัน
โครงสร้าง 1 ปี

พอลีก่อนเตียงผู้ป่วย 3 โกร้มือหมุน



45-70 องศา
ปรับระดับสูง-ต่ำ



0-80 องศา
ปรับระดับส่วนหัวเตียง



0-45 องศา
ปรับระดับส่วนข้อเท้า

ขนาดเตียง : 80x200x45 70 เซนติเมตร

MODEL : BM011

โครงสร้าง ทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น รับน้ำหนักอย่างถึกทนสมกับ
พื้นเตียง แบ่ง 4 ตอน ทำจากเหล็กทึบเกาะรูป

กลไก 2 โกร้มือหมุน


- ปรับด้านหัวเตียง ปรับได้ไม่น้อยกว่า 0-80 องศา
- ปรับด้านข้อเท้า ปรับได้ไม่น้อยกว่า 0-45 องศา
- ปรับระดับต่ำสุดจากพื้น ปรับได้ไม่น้อยกว่า 45 ซม. (ไม่รวมที่นอน)
- ปรับระดับสูงสุดจากพื้น ปรับได้ไม่น้อยกว่า 70 ซม. (ไม่รวมที่นอน)

หัวท้าย หัวท้ายพลาสติกขึ้นรูป ABS (ถอดได้)

ราวกันเตียง ทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดขึ้น-ลงได้

ขนาดเตียง (กว้างxยาวxสูง) 80x200x45-70 เซนติเมตร

รับน้ำหนักได้ ประมาณไม่เกิน 150 กิโลกรัม

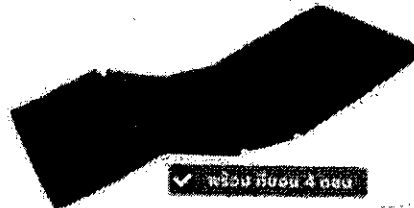

B-MED ช่องทางการสั่งซื้อ B-MED THAILAND

100/101 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี


โทร : 02-561-1111

B.MED

BM

Baanmor Thailand Co., Ltd.

7.คุณสมบัติเฉพาะไม้เท้า 1 จุด




BM


Baanmor(Thailand) CO., LTD.



8. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม้เท้า 3 จุด




1. โครงสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม





9. คุณสมบัติเฉพาะ Walker แบบพับเก็บได้




1. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียมแบบท่อกลมมี 4 ขา, 4. มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนัก ได้ได้ไม่เสื่อมหรือ โยกพละไ้ใช้งาน 9. มีน้ำหนักเบาพกพาสะดวก

BVI
Baanmor (Thailand) CO., LTD.




10. คุณสมบัติเฉพาะ Walker แบบพับเก็บได้






11. คุณสมบัติเฉพาะ Mobile Walker

5. สามารถพับเก็บได้




1. โครงเหล็กสำหรับช่วยพยุงเดิน มีล้อ



3. สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ

4. มีจุดขงกันลื่น

2. โครงสร้างผลิตจากอะลูมิเนียม




เตียงไม้เตี้ยมีราวกันเตียงแบบสไลด์

เตียงจอเนกประสงค์ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาล
คลินิก หรือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน



แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย
ออกแบบเพื่อการใช้งาน
ที่สะดวกและปลอดภัย



รับน้ำหนักได้
สูงสุด 200 กก.



คุณสมบัติสินค้า

- 1 พื้นเตียงทำจากไม้ หรือ ใช้โครงเหล็ก
และปิดผิวด้วยลายไม้
- 2 เบาะรองนอนรองรับสรีระได้ดี ไม่บีบเกินไป
กว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า
200 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
- 3 ความสูงจากพื้นถึงพนักเตียง (รวมที่นอน)
ไม่น้อยกว่า 30 - 45 เซนติเมตร
- 4 ความสูงของราวกันเตียงจากที่นอนขึ้นมา
ไม่น้อยกว่า 22-33 เซนติเมตร
- 5 ความกว้างของเตียงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
- 6 ความยาวของเตียงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร
- 7 มีราวกัน 2 ข้าง ทำจากไม้หรืออลูมิเนียม
สามารถพับเก็บหรือสไลด์ลงได้


รายละเอียดสินค้า



เบาะรองนอน ไม้บีบเกินไป
รองรับสรีระได้ดี



ราวกันดูลูมิเนียม 2 ข้าง
พับเก็บหรือสไลด์ลงได้สะดวก




โครงสร้างแข็งแรง มั่นคง
พื้นเตียงทำจากไม้ หรือโครงเหล็กปิดผิวด้วยไม้



ออกแบบเพื่อความปลอดภัย
ใช้งานสะดวกสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล

ขนาดสินค้า



รับประกันสินค้า
3 ปี หรือ 10,000 ชม.



ทีมช่างทีมโรงพยาบาล
มีบริการเพื่อความสะดวก




ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง
มาตรฐานสากล

บริษัท บีเอ็มอี (ประเทศไทย) จำกัด



13.คุณสมบัติเฉพาะโต๊ะพร้อมเตียง




1. เป็น โต๊ะพร้อมเตียงแบบเปิดไม้ได้ ชนิดสแตนเลส, 2. โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส



7

Portable Phlegm Suction Unit



7E-A Portable Phlegm Suction Unit

Features:

High negative pressure, large flux, low noise, it is a brand new mechanism design with suction bottle built in and square negative pressure meter crust. This design not only can reduce the made noise level but also makes it more precise.

It adopts advanced overflow-protection design, which can prevent pus and mucus from leaking into the machine.

Compact, lightweight, and portable, suitable for emergency and outside use.

Technical data:

Input power: 90VA

Max negative pressure value: $\geq 0.075\text{MPa}$

Pumping rate: $\geq 15\text{L/min}$

Operation noise: $\leq 65\text{dB (A)}$

Reservoir volume: 1000mL, 1piece

Working system: short running

7E-D Portable Phlegm Suction Unit

This product can function under any of the three power source: alternating current and direct current and batteries. It is most used in situation where power source are lacking, such as on vehicles or in the outdoors.

Technical data:


DC Power supply: 12V

Input power: 44VA

Pumping rate: $\geq 15\text{L/min}$

Working system: Continuous operation with intermittent loading, maximum continuous working time is 30 minutes, continuity rate: 50%

Refer to 7E-A type for other functions and parameters.



7B-1 Manual suction apparatus

Technical data:


Max vacuum: $\geq 0.04\text{MPa}$

Max flow: $\geq 20\text{L/min}$

Suction bottle storage capacity: 200ml

Weight: 192g


Refer to 7B type for other functions and parameters.



BM

Baanmor(Thailand) CO.,LTD.

OXYGEN THERAPY



Oxygen Concentrator JAY-10

The JAY-10 provides concentrated oxygen to patients during treatment. It is a self-contained device based on the molecular sieve (artificial zeolite) method to separate nitrogen from air and extract oxygen.

The oxygen concentrator JAY-10 is equipped with a powerful oil-free compressor, supplying up to 10 liters per minute of oxygen to patients. In addition, the device has a supporting „cooling“ technology to improve its reliability and lifetime.

BM
Baanmor(Thailand) CO.,LTD.





Oxygen Concentrator JAY-10

LCD display shows:

- switch times
- operating pressure
- present working time
- accumulated working time

Technical data:

- Flow rate: 0.5 - 10 LPM
- Purity: 93 ($\pm 3\%$)
- Outlet pressure: 0.04 - 0.07 MPA
- Power consumption: 880 W
- Sound level: ≤ 52 dbA
- Net weight: 27 kg
- Size (mm): 365 x 375 x 600
- Input Frequency: 50Hz ; 60Hz
- Input Voltage: AC 230V/110V $\pm 10\%$




Having a reliable oxygen supply is necessary for the care of seriously ill patients to improve the probability of survival. Oxygen concentrators are a suitable and favorable option for administering health centers and hospitals, especially where cylinders and piped systems are inappropriate or unavailable. All our medical oxygen concentrators have a broad environmental operation spectrum. We provide different types of oxygen concentrators according to our partners needs.

For more information, please contact us. We remain at your service!

BM
Baanmor(Thailand) CO., LTD.

MEDICAL OXYGEN CONCENTRATOR

MODEL: JAY-5AW



Low noise,
takes up less space



USA imported humidifier,
6PSI pressure release



Innovative big
LCD display

Specification

Flow Rate	0-5LPM
Purity	93% (±3%)
Outlet Pressure	0.05-0.07MPA(6-10 PSI)
Sound Level	<40db
Power Consumption	<350w
LCD Display	Switch times, operating pressure, present working time, accumulated working time, presetting time from 10mins to 40hours
Alarm	Power failure alarm, High&low pressure alarm, Low purity alarm
Net Weight	16 Kgs
Size	348×280×510 mm

BM
Baanmor(Thailand) CO., LTD.

โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ใบเสนอราคาบันทึกต่อราคาและปริมาณงาน

แนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๗ /๒๕๖๙


ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๕ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(.....นายสุศักดิ์ สมภักดี.....)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....นางสาวสุภาพร แสงสูงเนิน.....)


ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางละอองดาว บำรุงญาติ.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๑๐๘๗/๒๑ถนน เคนหะร่มเกล้าแขวง คลองสองต้นนุ่นเขต ลาดกระบังจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๒๗๔๐๔๒ โดย นายไชยันต์ ลิหะมัด ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๗/๒๕๖๙ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	โครงการศูนย์สาธิตและยิมอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟู สมรรถภาพที่บ้าน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	-	๑ โครงการ	๔,๔๘๓,๙๕๐.๐๐	๔๕
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔,๔๘๓,๙๕๐.๐๐	

(สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษี อากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืด ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ

๕.๐๐ ขอรราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับผิดชอบการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นขอเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓๓๕,๖๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอใน คราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๑:๔๗:๒๕ น.

(นายไชยันต์ ลิ้มมัด)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๙๐๓๙๔๑๐๒๔๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๙๐๗๑๖๐๐๒๘๙๑๑

รหัสอ้างอิง OTP 5ML1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๖๐๘๔๐๗๕

บันทึกต่อรองราคา

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๔๓๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อ โครงการศูนย์สาธิตและนิมิตอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามท้ายนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ผลปรากฏว่า บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาในวงเงิน ๔,๔๘๓,๔๕๐.- บาท (สี่ล้าน-สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาการอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันต่อรองราคา กับ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏว่า

☐ ขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน - บาท (-)

☒ ยินยอมลดราคาจากราคาที่เสนอเป็นเงิน ๓,๔๕๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบ ๔๕ วัน คงเดิม

คณะกรรมการฯ ได้บันทึกและอ่านข้อความข้างต้นให้ฟังโดยละเอียดแล้ว รับว่าเป็นการถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายไชยันต์ ลิหัต)

ตำแหน่ง ผู้มีอำนาจลงนาม



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางโชติรส อาดำ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวชฎากาญจน์ รอดสการ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจรรยาลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบใบประเมินราคา

เขียนที่ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง เสนอราคา

เรียน ประธานและคณะกรรมการประกวดราคา

ข้าพเจ้า...บริษัทบ้านหมอ(ประเทศไทย) จำกัด....สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1087/21 ถนน เติร์มเกส้า
ตำบล/แขวง คลองสองต้นนุ่น อำเภอ/เขต ลาดกระบัง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....
10520.....โทรศัพท์.....02-3299947

ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไข/ข้อตกลงของทางส่วนงานแล้ว จึงขอเสนอราคาตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	พื้นอนลม	150 ชุด	2,500.00	375,000.00	
2	รถเข็นนั่ง	200 คัน	2,390.00	478,000.00	
3	รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย	40 คัน	5,900.00	236,000.00	
4	เก้าอี้นั่งถ่าย	10 อัน	1,900.00	19,000.00	
5	รถสามล้อโยก	50 คัน	6,200.00	310,000.00	
6	เตียงปรับระดับได้ 3 โกร	180 หลัง	13,400.00	2,412,000.00	
7	ไม้เท้า 1 จุด	100 อัน	150.00	15,000.00	
8	ไม้เท้า 3 จุด	100 อัน	383.00	38,300.00	
9	Walker แบบพับไม่ได้	120 อัน	400.00	48,000.00	
10	Walker แบบพับได้	50 อัน	950.00	47,500.00	
11	Mobile walker	10 อัน	1,100.00	11,000.00	
12	เตียงไม้เตี้ยมีราวกัน	40 หลัง	5,000.00	200,000.00	
13	โต๊ะคร่อมเตียง	10 อัน	3,500.00	35,000.00	
14	เครื่องดูดเสมหะ	10 เครื่อง	2,660.00	26,600.00	
15	เครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร	5 เครื่อง	27,000.00	135,000.00	
16	เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร	5 เครื่อง	18,720.00	93,600.00	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)				4,480,000.00	

สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน

(.....)

(ตัวหนังสือ)

กำหนดส่งมอบ.....45.....วัน

กำหนดยื่นราคาภายใน.....240.....วัน



ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....นายไชยันต์ ลิหมัด.....)

ตำแหน่ง.....ผู้มีอำนาจลงนาม.....

ประทับตรา (ถ้ามี)